

AUDAR®

User Manual

KERi



August International Ltd

Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.audarwatch.com

- EN** Smart Healthcare Wristband
- FR** Bracelet Connecté Santé
- DE** Intelligentes Armband für das Gesundheitswesen
- IT** Braccialeto Smart Healthcare
- ES** Pulsera Inteligente de Salud

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses August Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung. Bitte öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Dies kann gefährlich sein, außerdem erlischt damit die Herstellergarantie.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden: <http://augustint.com/en/declaration/>

Kundenservice







Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com

1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung und Benutzung

	Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.		Lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
	Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.		Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.
	Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es beschädigt werden könnte.		Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

■ Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehörteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

	Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.		Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven oder grobkörnigen Reinigungsmitteln wie z. B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.
---	---	--	---

2. Hauptmerkmale

- Schrittzähler mit Distanz.- und Kalorienmessung
- Herzfrequenz.- und Blutdruckmessung
- Schlafracker zur Überwachung der Schlafqualität
- Kontrastreiches TFT-Farbdisplay
- SMS-, Anruf.- und Ereigniserinnerung mit Vibrationsalarm

3. Lieferumfang



KERI



Ladekabel



Bedienungsanleitung

4. Teile und Funktionen



1. TFT-Farbdisplay
2. Touch-Taste
3. USB Ladestecker
4. Multifunktionssensor
5. Armband Clip

Schnellstartanleitung

1. Scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Gerät oder suchen Sie nach AUDAR im Google Play Store oder im Apple App Store um die App herunterzuladen und zu installieren.



Benötigt Android 4.3 und höher oder iOS 8.0 und höher.

1. Bitte laden Sie das KERi Fitnessarmband vor der ersten Nutzung oder nach längerem nicht benutzen vollständig auf. Um das Gerät aufzuladen entfernen Sie die abnehmbare Seite des Armbandes. Die abnehmbare Seite des Armbandes ist auf der unteren Seite mit Richtungspfeilen und einem USB-Symbol markiert. Dadurch wird der USB-Ladestecker sichtbar, der mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an einem stromversorgten USB-Anschluss angeschlossen wird. Wenn das KERi Fitnessarmband nicht aufgeladen wird, stecken Sie es bitte in umgekehrter Richtung in das USB-Ladekabel.
2. Das Akkusymbol füllt sich während des Ladevorgangs. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung am USB-Anschluss oder am Ladegerät 5V beträgt.
3. Halten Sie die Touch-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt um das KERi Fitnessarmband einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass sich das KERi Fitnessarmband nicht weiter als 10 Meter von Ihrem Gerät entfernt befindet. Starten Sie die AUDAR App und drücken Sie auf "Armband verbinden" um das Armband zu koppeln. Stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigungen erteilen und die Systemanforderungen akzeptieren wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Geben Sie nach dem Koppeln die angeforderten persönlichen Daten ein und klicken Sie auf "Weiter". Legen Sie dann Ihr Gesundheitsziel fest (z.B. die Anzahl der Schritte, die Sie täglich ausführen möchten). Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Speichern, um zur Startseite der App zu gelangen.
6. Das Armband ist nun Einsatzbereit.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	1
2. Hauptmerkmale	1
3. Lieferumfang	2
4. Teile und Funktionen	2
5. Bedienung	5
5.1 Armband	5
5.1.1 Zeit und Datum (Standardanzeige)	5
5.1.2 Schritte, Distanz und Kalorien	6
5.1.3 Sportmodus	6
5.1.4 Schlafmodus	7
5.1.5 Herzfrequenz	7
5.1.6 Blutdruck	7
5.1.7 Blutsauerstoff	8
5.1.8 Nachrichten	8
5.1.9 Stoppuhr	8
5.1.10 Gerät finden	9
5.1.11 KERi-Informationen	9
5.1.12 Aus-Modus	10
5.1.13 Helligkeit	10
5.2 AUDAR Anwendungen	11
5.2.1 Armband verbinden	11
5.2.2 Persönliche Informationen	12
5.2.3 Startseite	12
5.2.3.1 Manuelle Messung	13
5.2.3.2 Schritte	13
5.2.3.3 Schlaf	14
5.2.3.4 Herzfrequenz	15
5.2.3.5 Blutdruck	16
5.2.3.6 Blutsauerstoff	17
5.2.3.7 Ermüdung	18
5.2.4 Geräteoptionen	19
5.2.4.1 Persönliche Informationen	19
5.2.4.2 Wochenreport	20
5.2.4.3 Kamera aktivieren	20
5.2.4.4 Joggen	20
5.2.4.5 Gerätemanagement	21
5.2.4.6 Allgemeine Einstellungen	23
5.2.4.7 Über	23
5.2.4.8 CareMate Information	23
6. Aufladen	26
7. Problemlösung	27
8. Technische Daten	28
9. Garantie	29

5. Bedienung

5.1 Armband

Halten Sie die Touch-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt um das KERi Fitnessarmband einzuschalten.


Zum Ausschalten des KERi Fitnessarmband

1. Drücken Sie die Touch-Taste um den Aus-Modus auszuwählen.
2. Halten Sie die Touch-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt.
3. Drücken Sie die Touch-Taste und wählen „Ja“.
4. Halten Sie die Touch-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt um zu bestätigen, dass Sie das Armband ausschalten möchten.

Drücken Sie die Touch-Taste um den Bildschirm zu aktivieren. Nach der Aktivierung leuchtet der Bildschirm für ca. 5 Sekunden auf. Während der Bildschirm aktiviert ist drücken Sie die Touch-Taste um die folgenden Modi zu durchlaufen: Uhrzeit und Datum (Standardanzeige), Schritte, Distanz, Kalorien, Sportmodus, Schlafmodus, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Massagen, Stoppuhr, Gerät finden, Ker-Informationen, Aus-Modus und Helligkeit.

Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.


5.1.1 Zeit und Datum (Standardanzeige)



Bluetooth-Verbindungsstatus
(Wird angezeigt wenn verbunden) Akkustatus
Zeit
Datum (TT/MM)
Tag
Schritte




Theme1



Theme2

Uhrzeit und Datum werden automatisch eingestellt wenn Sie das KERi Fitnessarmband verbinden. Halten Sie die Touch-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt um die verschiedenen Modi auszuwählen.

5.1.2 Schritte, Distanz und Kalorien



Das KERi Fitnessarmband zeigt die Anzahl der Schritte an die Sie zurückgelegt haben. Für eine genaue Anzeige empfehlen wir Ihnen, dass die im Abschnitt "Persönliche Informationen" angegebenen Daten so genau wie möglich sind (siehe 5.2.2).

Das KERi Fitnessarmband berechnet die zurückgelegte Distanz aus der Anzahl der Schritte die Sie unternommen haben. Für eine genaue Anzeige empfehlen wir Ihnen, dass die im Abschnitt "Persönliche Informationen" eingegebenen Daten so genau wie möglich sind (siehe 5.2.2).

Das KERi Fitnessarmband berechnet die Kalorien die Sie verbraucht haben anhand der Anzahl der zurückgelegten Schritt.

5.1.3 Sportmodus



Laufen




Radfahren



Wandern


Halten Sie die Touch-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt um den Sportmodus zu aktivieren. Drücken Sie nun die Touch-Taste erneut und wählen ihren gewünschten Sportmodus aus. Es gibt drei Arten von Sportmodi: Laufen, Radfahren und Wandern. Halten Sie nach Auswahl des gewünschten Sportmodus die Touch-Taste 5 Sekunden gedrückt um den entsprechenden Sportmodus zu aktivieren. Drücken Sie während des Trainings die Touch-Taste um zu pausieren oder erneut um fortzusetzen. Drücken Sie nach dem Training die Touch-Taste um zu pausieren und halten anschließend die Touch-Taste für 5 Sekunden gedrückt um das Menü zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

5.1.4 Schlafmodus



Wenn Sie in den Schlafmodus wechseln zeigt das KERi Fitnessarmband Daten zu Ihrem Schlaf an.

5.1.5 Herzfrequenz




Wenn Sie in den Herzfrequenzmodus wechseln, beginnt das KERi Fitnessarmband mit der Messung Ihrer Herzfrequenz. Dies kann bis zu einer Minute dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, vibriert das KERi Fitnessarmband und zeigt Ihre aktuelle Herzfrequenz in BPM (Schläge pro Minute) an.

5.1.6 Blutdruck



Wenn Sie in den Blutdruckmodus wechseln, beginnt das KERi Fitnessarmband Ihren Blutdruck zu messen. Dies kann bis zu einer Minute dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, vibriert das KERi Fitnessarmband und zeigt Ihren aktuellen Blutdruck an.

5.1.7 Blutsauerstoff



Blutsauerstoffgehalt

Wenn Sie in den Blutsauerstoffmodus wechseln, beginnt das KERi Fitnessarmband mit der Messung Ihres Blutsauerstoffgehalts. Dies kann bis zu einer Minute dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, vibriert das KERi Fitnessarmband und zeigt Ihren Blutsauerstoffgehalt an.

5.1.8 Nachrichten



Wenn Sie in den Nachrichtenmodus wechseln zeigt das KERi Fitnessarmband eine Zusammenfassung der Nachrichten auf Ihrem Telefon an. Halten Sie die Touch-Taste 5 Sekunden gedrückt und das KERi Fitnessarmband zeigt Details zu den Nachrichten an. Drücken Sie erneut die Touch-Taste um die Nachrichten umzuschalten. Halten Sie die Touch-Taste 5 Sekunden gedrückt um zum Hauptmenü zurückzukehren.

5.1.9 Stoppuhr




Minuten
Sekunden
Millisekunden

Halten Sie die Touch-Taste 5 Sekunden gedrückt um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie die Touch-Taste erneut um die Stoppuhr anzuhalten oder fortzusetzen.

Halten Sie im Pausenmodus die Touch-Taste 5 Sekunden gedrückt um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Hinweis: Die Stoppuhr kann maximal 99 Minuten (1 Stunde und 39 Minuten) lang die abgelaufene Zeit anzeigen. Nach Ablauf dieser Zeit startet die Stoppuhr wieder bei 00:00Uhr erneut.

5.1.10 Gerät finden




Verbundenes Gerät finden

Halten Sie die Touch-Taste 5 Sekunden gedrückt um die Funktion "Mein Telefon suchen" zu aktivieren. Das gekoppelte Gerät klingelt oder vibriert, je nach Einstellung, sodass Sie es lokalisieren können.

Hinweis: Das gekoppelte Gerät muss sich in Bluetooth-Reichweite befinden um gefunden zu werden (10m). Wenn Sie das Gerät nicht hören können, verändern Sie Ihre Position und aktivieren die Funktion erneut.

5.1.11 KERi-Informationen



KERi's MAC Informationen

Im Abschnitt KERi-Informationen erhalten Sie eine eindeutige Kennung für das KERi Fitnessarmband. Dies ist nützlich wenn Sie das Armband verbinden wollen während sich mehrere KERi Fitnessarmbänder in der Nähe befinden.

5.1.12 Aus-Modus




Aus-Modus

Halten Sie im Aus-Modus die Touch-Taste 5 Sekunden gedrückt und wählen anschließend mit der Touch-Taste „Ja“ aus. Halten Sie nun erneut die Touch-Taste 5 Sekunden gedrückt, um zu bestätigen, dass Sie das KERi Fitnessarmband ausschalten möchten.

5.1.13 Helligkeit



Helligkeit



Vier Helligkeitsstufen

Halten Sie im Abschnitt Helligkeit die Touch-Taste 5 Sekunden gedrückt um die Funktion für die Helligkeitseinstellungen zu aktivieren. Es gibt vier Helligkeitsstufen. Drücken Sie die Touch-Taste um die Helligkeitsstufen zu ändern. Halten Sie nach Auswahl der geeigneten Helligkeit die Touch-Taste erneut 5 Sekunden gedrückt um die Einstellung zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren.

Hinweis: Wenn das KERi Fitnessarmband bei starker äußerer Helligkeit verwendet wird, empfehlen wir die Helligkeit auf die höchste Stufe einzustellen. Der Akkuverbrauch steigt jedoch mit zunehmender Helligkeit.

5.2 AUDAR Anwendungen

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder suchen Sie nach "AUDAR" im Google Play Store oder im Apple App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren.





Benötigt entweder Android 4.3 und höher oder iOS 8.0 und höher.

5.2.1 Armband verbinden

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und stellen Sie sicher, dass es sich nicht weiter als 10 Meter vom KERi Fitnessarmband entfernt befindet.
2. Starten Sie die „AUDAR“ App und wählen Sie „Armband verbinden“.
3. Wählen Sie das KERi Fitnessarmband aus der Geräteliste aus.
4. Wenn mehr als ein KERi Fitnessarmband in der Nähe ist, überprüfen Sie bitte die MAC-Adresse Ihres Armbandes um das richtige auszuwählen. (siehe 5.1.11).
5. Nach dem das KERi Fitnessarmband verbunden wurde, wird das Bluetooth Symbol auf dem Armband angezeigt.


Hinweis: Stellen Sie bei Android-Geräten sicher, dass Sie „AUDAR“ die Systemberechtigung erteilen wenn Sie dazu aufgefordert werden. Stellen Sie bei iOS-Geräten sicher, dass Sie die Bluetooth-Verbindungsanforderung bestätigen wenn Sie dazu aufgefordert werden.



5.2.2 Persönliche Informationen


Geben Sie nach dem Verbinden des KERI Fitnessarmband die angeforderten persönlichen Daten ein und klicken Sie auf "Weiter". Legen Sie dann Ihr Gesundheitsziel fest (die Anzahl der Schritte die Sie täglich ausführen möchten). Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Speichern, um zur Startseite zurückzukehren.

Sie können diese Informationen jederzeit später bearbeiten. Weitere Anweisungen finden Sie in .

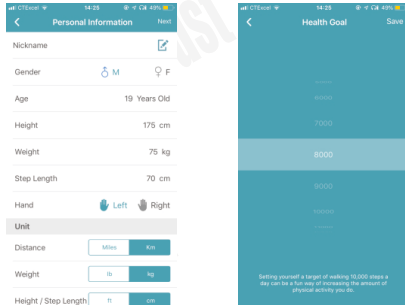

5.2.3 Startseite

Auf der Startseite werden die Anzahl der von Ihnen zurückgelegten Schritte, die Zeit die Sie geschlafen haben, sowie die letzten Messungen Ihrer Herzfrequenz, Ihres Blutdrucks, Ihres Blutsauerstoffgehalts und Ihres Müdigkeitszustands angezeigt.




Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

5.2.3.1 Manuelle Messung

Mit der manuellen Messfunktion können Sie Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck, Ihren Blutsauerstoffgehalt und Ihren Müdigkeitszustand messen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet. Der Ermüdungsgrad wird durch einen mathematischen Algorithmus berechnet der auf anderen Messungen basiert.

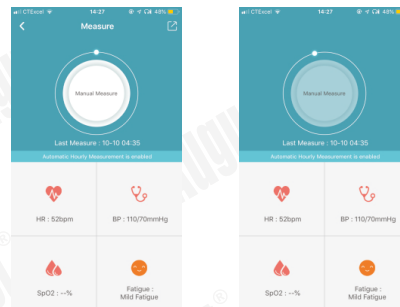


1. Drücken Sie oben rechts auf der Startseite auf "Messung" um die manuelle Messfunktion zu öffnen.
2. Drücken Sie auf „Manuelle Messung“ um mit der Messung zu beginnen.
3. Wenn Sie fertig sind werden die Messungen auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf einen der Abschnitte um sich detailliertere Informationen anzuzeigen zu lassen.

5.2.3.2 Schritte

Die aktuelle Schrittzahl wird auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf den Abschnitt „Laufen“ um sich weitere Informationen anzeigen zu lassen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

- Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen.
- Tippen Sie auf eine Leiste in der Tabelle um die genaue Anzahl der zurückgelegten Schritte anzuzeigen.
- Unterhalb des Balkendiagramms finden Sie weitere Informationen zu den zurückgelegten Schritten, der zurückgelegten Entfernung und dem Kalorienverbrauch.
- Drücken Sie auf das <Notizen> Symbol um Ihr Gesundheitsziel zu ändern (die Anzahl der Schritte die Sie täglich ausführen möchten).
- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um die Länge des angezeigten Zeitraums zu ändern.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.




5.2.3.3 Schlaf

Die neuesten Daten zu Ihrem Schlaf werden auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf der Startseite auf den Abschnitt „Schlaf“ um weitere Informationen anzuzeigen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

- Slide the date to the right to view older data.
- Tap a bar on the chart to view the exact amount of sleep during that time.
- Select a day, week or month to change the length of the period displayed.
- Press share and choose a social media service to share your recent sleep data.





5.2.3.4 Herzfrequenz

Die zuletzt gemessene Herzfrequenz wird auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf der Startseite auf den Abschnitt „Herzfrequenz“ um weitere Informationen anzuzeigen oder eine Messung durchzuführen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

- Die letzte Messung wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie auf <Einzelmessung> um eine neue Messung durchzuführen.
- Drücken Sie auf <Echtzeitmessung> um Ihre Herzfrequenz in Echtzeit anzuzeigen. Drücken Sie erneut auf <Echtzeitmessung> um sie zu deaktivieren. Hinweis: Die Echtzeitmessung muss deaktiviert werden um zur Startseite zurückzukehren.
- Weitere Messungen werden in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Schieben Sie den Bildschirm nach oben um ältere Messungen anzuzeigen.
- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um ein Balkendiagramm Ihrer Herzfrequenzmessungen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Leiste im Diagramm um detailliertere Informationen anzuzeigen. Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen. Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.





5.2.3.5 Blutdruck

Der zuletzt gemessene Blutdruck wird auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf der Startseite auf den Abschnitt „Blutdruck“ um weitere Informationen anzuzeigen oder eine Messung durchzuführen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

- Die letzte Messung wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie auf <Einzelmessung> um eine neue Messung durchzuführen.
- Drücken Sie auf <Echtzeitmessung> um Ihren Blutdruck in Echtzeit anzuzeigen. Drücken Sie erneut auf <Echtzeitmessung> um sie zu deaktivieren. Hinweis: Die Echtzeitmessung muss deaktiviert werden um zur Startseite zurückzukehren.
- Weitere Messungen werden in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Schieben Sie den Bildschirm nach oben um ältere Messungen anzuzeigen.
- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um ein Balkendiagramm Ihrer Blutdruckmessungen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Leiste im Diagramm um detailliertere Informationen anzuzeigen. Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.




5.2.3.6 Blutsauerstoff

Der zuletzt gemessene Blutsauerstoff wird auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf der Startseite auf den Abschnitt „Blutsauerstoff“ um weitere Informationen anzuzeigen oder eine Messung durchzuführen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.



- Die letzte Messung wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie auf <Einzelmessung> um eine neue Messung durchzuführen.
- Drücken Sie auf <Echtzeitmessung> um Ihren Blutsauerstoff in Echtzeit anzuzeigen. Drücken Sie erneut auf <Echtzeitmessung> um sie zu deaktivieren. Hinweis: Die Echtzeitmessung muss deaktiviert werden um zur Startseite zurückzukehren.
- Weitere Messungen werden in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Schieben Sie den Bildschirm nach oben um ältere Messungen anzuzeigen.
- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um ein Balkendiagramm Ihrer Blutsauerstoffmessung anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Leiste im Diagramm um detailliertere Informationen anzuzeigen. Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.



5.2.3.7 Ermüdung


Der Ermüdungszustand wird auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf den Abschnitt „Müdigkeit“ um detailliertere Informationen anzuzeigen oder eine neue Messung durchzuführen.

- Die letzte Messung wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie auf <Messung starten> um eine neue Messung durchzuführen.
- Weitere Messungen werden in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Schieben Sie den Bildschirm nach oben um ältere Messungen anzuzeigen.
- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um ein Balkendiagramm anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Leiste im Diagramm um detailliertere Informationen anzuzeigen. Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und Wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.



5.2.4 Geräteoptionen

Drücken Sie <☰> (oben links) um das Menü mit den Geräteoptionen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine der Optionen um den entsprechenden Bereich aufzurufen.




5.2.4.1 Persönliche Informationen

In diesem Abschnitt können Sie sich die folgenden persönlichen Informationen anzeigen lassen und verändern:

- Geschlecht
- Alter
- Größe
- Gewicht
- Schrittlänge
- Tragehand
- Einheiten wählen für:
 - Distanz
 - Größe
 - Gewicht
 - Zeitformat
- Schlaf Einstellungen
- -Einschlafzeit
- -Aufwachzeit
- Blutdruck Referenzwert
- Systolisch
- Diastolisch

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Speichern, um zur Startseite der App zurückzukehren.



5.2.4.2 Wochenreport

In dem Wochenreport bekommen Sie einen Überblick über alle Daten der Vorwoche.



5.2.4.3 Kamera aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie, durch die Bewegung des KERi Fitnessarmband mit Ihrem Handgelenk, die Kamera Ihres Telefons automatisch aktivieren.

1. Tippen Sie auf "Kamera aktivieren" um zu beginnen.
2. Sobald die Kamera aktiviert ist, bewegen Sie das KERi Fitnessarmband mit ihrem Handgelenk, um ein Foto aufzunehmen.
3. Drücken Sie auf "Abbrechen" (x) um zur Startseite zurückzukehren.




5.2.4.4 Joggen

Diese Funktion hilft Ihnen Ihren Lauf zu überwachen.

Klicken Sie auf "Gesamte Laufzeit" um Ihren Verlauf der letzten Aktivitäten anzuzeigen.





Drücken Sie auf "Start" um mit dem Laufen zu beginnen.

- Drücken Sie die \leftarrow (Karte anzeigen) um zwischen Normal- und Kartenanzeige zu wechseln.
- Halten Sie die gelbe Taste gedrückt um zu pausieren.
- Drücken Sie die grüne Taste um ihren Lauf fortzusetzen.
- Drücken Sie die rote Taste um ihren Lauf zu beenden.



5.2.4.5 Gerätemanagement

In dem Bereich „Gerätemanagement“ können Sie den Akkuladestand des KERi Fitnessarmband überprüfen und die folgenden Funktionen verwenden:

- Verbindungsmanagement
 - Zeigt Ihnen den Verbindungsstatus des Armbandes an.
 - Sie können hier die Verbindung des Armbandes trennen
- Suche Armband
 - Wenn Sie auf "Suche Armband" klicken, vibriert das Armband und Sie können es besser finden. Hinweis: Die Suchfunktion funktioniert nur, wenn sich das Armband innerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet. (10m)
- Erinnerung (Ermöglicht das Einstellen stiller Vibrationsbenachrichtigungen)
 - Anrufmitteilung: <  > wird angezeigt wenn ein Anruf eingeht
 - Nachrichtmitteilung: <  > wird angezeigt wenn eine Nachricht eingeht.
 - Wecker: Das Armband vibriert zur eingestellten Zeit und das <  > wird auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf „Speichern“ wenn Sie ihre eingaben gemacht haben.
 - Keine Bewegung für längere Zeit: Während der Aktivierung wird das Armband vibrieren und dieses Symbol anzeigen <  >, sollten Sie sich für mind. 45 aufeinander folgende Minuten sitzen oder sich nicht bewegen. Klicken Sie auf „Speichern“ wenn Sie ihre eingaben gemacht haben.
 - App Mitteilungen: In diesem Abschnitt können Sie festlegen, ob Benachrichtigungen aus einer Reihe von Apps wie Facebook, Twitter, WhatsApp usw., angezeigt werden sollen.
 - Nicht stören: Mit der Funktion „Nicht stören“ können Sie einen Zeitraum festlegen, in dem alle Benachrichtigungen ignoriert werden (z. B. nachts von 23:00 bis 08:00 Uhr). Klicken Sie auf „Speichern“ wenn Sie ihre eingaben gemacht haben.
- Automatische Bildschirmaktivierung: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bildschirm des Keri Fitnessarmband aktiviert sobald Sie Ihr Handgelenk bewegen.
- Automatische Stündliche Messung: Wenn diese Option aktiviert ist, wird stündlich automatisch eine Messung durchgeführt. Wir empfehlen diese Funktion zu aktivieren um die genauesten Daten zu erhalten.
- Firmware Upgrade: Diese Seite zeigt die aktuelle Version des Armbandes an und informiert Sie ob eine neuere Version verfügbar ist.



5.2.4.6 Allgemeine Einstellungen

- Persönliche Informationen: Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 5.2.4.1.
- Gesundheitsziel: Mit dieser Option können Sie die Anzahl der Schritte festlegen, die Sie täglich ausführen möchten.
- Ermöglicht Ihnen Apps von Drittanbietern zu integrieren
 - Apple Health (nur für Apple Geräte)
 - Google Fit (nur für Android Geräte)
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Ermöglicht das vollständige zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Dabei werden alle Daten gelöscht und die Verbindung zwischen der App und dem Armband wird getrennt.
- Alle Daten der App löschen: Mit dieser Option können Sie alle in der App gespeicherten Daten löschen..
- Alle Daten vom Armband löschen: Mit dieser Option können Sie alle auf dem Armband gespeicherten Daten löschen.

5.2.4.7 Über



Im Abschnitt „Über“ wird die aktuelle Version der Anwendung angezeigt und Sie können auf die Hilfefunktion zugreifen.

Unter "Hilfe" können Sie folgendes tun:


- Senden Sie uns Feedback und geben Sie uns Empfehlungen zum Armband oder zur August AUDAR-Anwendung oder melden Sie uns einen Fehler.
- Häufig gestellte Fragen (FAQ): Zeigt Ihnen eine Liste häufig gestellter Fragen an (Drücken Sie auf eine der Fragen um einen Lösungsvorschlag zu bekommen).

6.2.4.8 CareMate Information

- Bewegungs- und Gesundheitsdaten von Personen abonnieren
- Bewerbungen als CareMate können über die Handynummer oder E-Mail-Adresse eingereicht werden, die bei der Registrierung für ein AUDAR-Konto verwendet wurde.




Sobald die Anfrage genehmigt ist, können Sie oben rechts auf "Meine Wächter" klicken, um eine Liste der Nutzer anzuzeigen, denen Sie folgen, und deren Bewegungs- und Gesundheitsdaten in Echtzeit zu überwachen.



Außerdem kann durch Scannen des QR-Codes eines anderen Nutzers eine Folgeanfrage gestellt werden. Die QR-Code-Informationen befinden sich im Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke.

• Pflegeanfrage


Sie können jede CareMate-Anfrage genehmigen oder ablehnen, indem Sie im Dropdown-Menü oben rechts auf "Pflegeanfrage" klicken.



• Care Me


Wenn Sie im Dropdown-Menü oben rechts auf 'Care Me' klicken, erhalten Sie eine vollständige Liste aller CareMates, die Ihnen folgt sind.

Die Sichtbarkeit der einzelnen Gesundheitsdaten für Ihren CareMate kann jederzeit durch Anklicken des jeweiligen CareMates in der Liste geändert werden.



6. Aufladen

Um das KERi Fitnessarmband aufzuladen entfernen Sie die abnehmbare Seite des Armbandes. Die abnehmbare Seite des Armbandes ist auf der unteren Seite mit Richtungspfeilen und einem USB-Symbol markiert. Dadurch wird der USB-Ladestecker sichtbar, der mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an einem stromversorgten USB-Anschluss angeschlossen wird. Wenn das KERi Fitnessarmband nicht aufgeladen wird, stecken Sie es bitte in umgekehrter Richtung in das USB-Ladekabel.



Das Akkuladesymbol füllt sich während des Ladevorgangs. Wenn der Akku vollständig geladen ist wird ein volles Akkuladesymbol angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung am USB-Anschluss oder am Ladegerät 5V beträgt.

7. Problemlösung

Probleme	Lösungsvorschläge
Gerät schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bitte laden Sie das Armband ■ Halten Sie die Touch-Taste 5 Sekunden lang gedrückt
Gerät wird nicht geladen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stecken Sie das Armband in umgekehrter Richtung in den USB-Anschluss oder in das Ladekabel ■ Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den USB-Anschluss an
Gerät wird nicht verbunden	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist ■ Vergewissern Sie sich, dass sich das Armband nicht weiter als 10m vom Gerät entfernt befindet ■ Vergewissern Sie sich, dass die Mac-Adresse auf dem Armband mit der in der App ausgewählten Mac-Adresse übereinstimmt ■ Stellen Sie sicher, dass Sie die Systemanforderungen akzeptieren
Gerät zeigt keine Daten in der App	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vergewissern Sie sich, dass das Armband mit dem Gerät gekoppelt ist ■ Versuchen Sie, die automatische stündliche Messung im Gerätemanagement zu aktivieren
Gerät erhält keine Nachrichten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vergewissern Sie sich, dass das Armband mit Ihrem Gerät gekoppelt ist ■ Überprüfen Sie die Erinnerungseinstellungen im Gerätemanagement

8. Technische Daten

OLED Screen	0,96 Zoll; 160x80Pixel
Chipset	Nordic NRF51832
Bluetooth Version	v4.2BLE
Herzfrequenzsensor	PixArt PAH8001
Integrierter Akku	Li-Polymer Akku 180mAh
Betriebsdauer	15 Tage
Standby	Bis zu 20 Tagen
Ladedauer	Ca. 2 Stunden
Armband Material	TPU
Schutzgrad	IP67
Nettogewicht	30g
Abmessungen	258 x 22 x 13,8mm

9. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßem Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

E-Mail: service-de@augustint.com

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: <http://www.augustint.com/en/declaration>.

